

A


Leiterplatte: 8200922-17,ST

- Abgleich und Pruefung nach FKV durchgefuehrt
- Schutzlackierung nicht durchgefuehrt
- Ausfuehrung nach DWN 3141, Klasse 2

B

alte Sachnummer ueberklebt mit:
8309136
Schild beschriftet mit:
2M22381-00
Serial-Nr. nach DMTN0419-A


C



D

hierzu: SPlan 8200773-17
FKV K02093

ST2M22381



E

<i>scale</i>		<i>general tolerances</i>		<i>material</i>		<i>safety class</i>	
						<i><s></i> 0 <i><m></i> 0	
<i>field reserved</i>				<i>revision text</i>			
<i>filing dept.</i> 2950		<i>responsible dept.</i> 5511		<i>author</i> 10.08.2000 Stickel		<i>approved</i> 10.08.2000 Kleinert	
						<i>contract</i> n	
<i>type</i> drawing		<i>language</i> de		<i>title</i> Best. LP Analog (Incubator)			
		<i>replacement for</i> 8200922-17		<i>number</i> 2M22381			
<i>creating system</i> CADRA		<i>release status</i> RELEASED		<i>revision index</i> 00		<i>occures</i> 00	
				<i>page/of</i> 01/01			

(2000 / CC / 336)

Dräger

Dräger Medizintechnik
GmbH
D-23542 Lübeck

size A4

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck


A

Leiterplatte: 8200922-16, ST
umgeruestet zu 2M22403-00
nach Umruestanweisung 2M22388

B

alte Sachnummer ueberklebt mit:
8309136
Schild beschriftet mit:
2M22403-00
Serial-Nr. nach DMTN0419-A


C



D

hierzu: SPlan 8200773-17
FKV K02093

ST2M22403



E

scale		general tolerances		material		safety class	
						<s> 0 <m> 0	
field reserved				revision text			
filing dept. 2950		responsible dept. 5511		author 02.08.2000 Stickel		approved 02.08.2000 Kleinert	
						(2000 / CC / 336) contract n	
type drawing		language de		title LP Analog, Ugr.			
		replacement for 8200922-16		number 2M22403			
creating system CADRA		release status RELEASED		revision index 00		occures 00	
				page/of 01/01		Dräger Medizintechnik GmbH D-23542 Lübeck	

F

size A4

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck


A

Leiterplatte: 8200922-13,ST
umgeruestet zu 2M22402-00
nach Umruestanweisung 2M22388

B

alte Sachnummer ueberklebt mit:
8309136
Schild beschriftet mit:
2M22402-00
Serial-Nr. nach DMTN0419-A


C

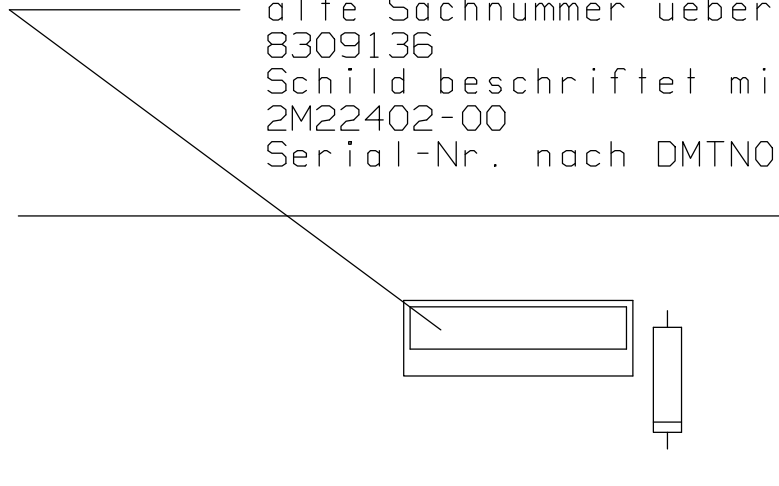

D

hierzu: SPlan 2M22392-00
FKV K02093

ST2M22402



E

scale	general tolerances	material		safety class	
				<s>	0
				<m>	0
field reserved		revision text			
filing dept. 2950	responsible dept. 5511	author 31.07.2000 Stickel	approved 31.07.2000 Kleinert	(2000 / CC / 336) contract n	
type drawing	language de	title LP Analog (Ugr.)			
	replacement for 8200922-13	number 2M22402			
creating system CADRA	release status RELEASED	revision index 00	occures 00		

F

Dräger Medizintechnik
GmbH
D-23542 Lübeck

size A4

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

A

Leiterplatte: 8200920-01,ST
umgeruestet zu 2M22401-00
nach Umruestanweisung 2M22388

B


alte Sachnummer ueberklebt mit:
8309136
Schild beschriftet mit:
2M22401-00
Serial-Nr. nach DMTN0419-A

C

D

hierzu: SPlan 2M22392-00
FKV K02093

ST2M22401



E

<i>scale</i>		<i>general tolerances</i>		<i>material</i>		<i>safety class</i>	
						<i><s></i> 0 <i><m></i> 0	
<i>field reserved</i>				<i>revision text</i>			
<i>filing dept.</i> 2950		<i>responsible dept.</i> 5511		<i>author</i> 31.07.2000 Stickel		<i>approved</i> 31.07.2000 Kleinert	
						<i>contract</i> n	
<i>type</i> drawing		<i>language</i> de		<i>title</i> Best. LP Analog (Incubator)			
		<i>replacement for</i> 8200920-16		<i>number</i> 2M22401			
<i>creating system</i> CADRA		<i>release status</i> RELEASED		<i>revision index</i> 00		<i>occures</i> 00	
				<i>page/of</i> 01/01			

Dräger

Dräger Medizintechnik
GmbH
D-23542 Lübeck

size A4

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

A

Leiterplatte: 8200920-00,ST
umgeruestet zu 2M22400-00
nach Umruestanweisung 2M22388

B


alte Sachnummer ueberklebt mit:
8309136
Schild beschriftet mit:
2M22400-00
Serial-Nr. nach DMTN0419-A

C

D

hierzu: SPlan 2M22392-00
FKV K02093

ST2M22400



E

<i>scale</i>		<i>general tolerances</i>		<i>material</i>		<i>safety class</i>	
						<i><s></i> 0 <i><m></i> 0	
<i>field reserved</i>				<i>revision text</i>			
<i>filing dept.</i> 2950		<i>responsible dept.</i> 5511		<i>author</i> 03.08.2000 Stickel		<i>approved</i> 03.08.2000 Kleinert	
						<i>contract</i> n	
<i>type</i> drawing		<i>language</i> de		<i>title</i> Best. LP Analog (Incubator)			
		<i>replacement for</i> 8200920-00		<i>number</i> 2M22400			
<i>creating system</i> CADRA		<i>release status</i> RELEASED		<i>revision index</i> 00		<i>page/of</i> 01/01	
				<i>occures</i> 00			

Dräger Medizintechnik
GmbH
D-23542 Lübeck

F

size A4

8301853 (7/25) um 20° bis 30°
in Richtung R22 gebogen
Pin3 entfernt

8301853 (4/25) (2x)
1814508 (2x)

1329987 (2x)
D04766 (2x)
1334913 (2x)
8303296 gekennzeichnet mit 2 mm Schrifthöhe :
8200922-17
Serial-Nr. nach DMTN0419-A
8301853 (13/25) (2x)

8200771

8302725

- Ausführung nach DWN 3141, Klasse 2
- C1 und C12 auf LP liegend eingelötet
oder zur Seite gebogen

hierzu: Stückliste ST8200922

⑰ 8301566

1205633 (0,02lg)
(Schrumpfsh. 12-4X sw-8304999)
G1 mit Heisskleber fixiert

1809865 (2x)

1338935 (2x)

8300286 (9 x) ⑰


1826131
mit Heisskleber fixiert

Schaltplan nach DWN 3141 beschreiben.
Use of this document is limited to the
Dräger Medical Technology GmbH, D-23542 Lübeck

-QA-	-	-QB-	-	-QC-	-
Werkstoff					
				17	8X
Fassung neu, C13, R111 u. R112 entfernt Sachnr. N6, Text geändert, Menge geändert. (00/cc/321)					
Änderungen					
Maßstab	Allgemein- toleranzen	Abteilung	2000 Tag	Name	
2:1	-	MT	14.07	Faber	
Benennung			Gepr.	Klebert	
LP Analog, Ugr. (Inkubator)			Zeichnungs-Nr. 8200922 Blatt 1 von 9 Bl.		
Ersatz für			Ersatz durch		
HPDC-6			8200922 "16"		

Dräger Medical Technik
GmbH, D-23542 Lübeck

Dräger

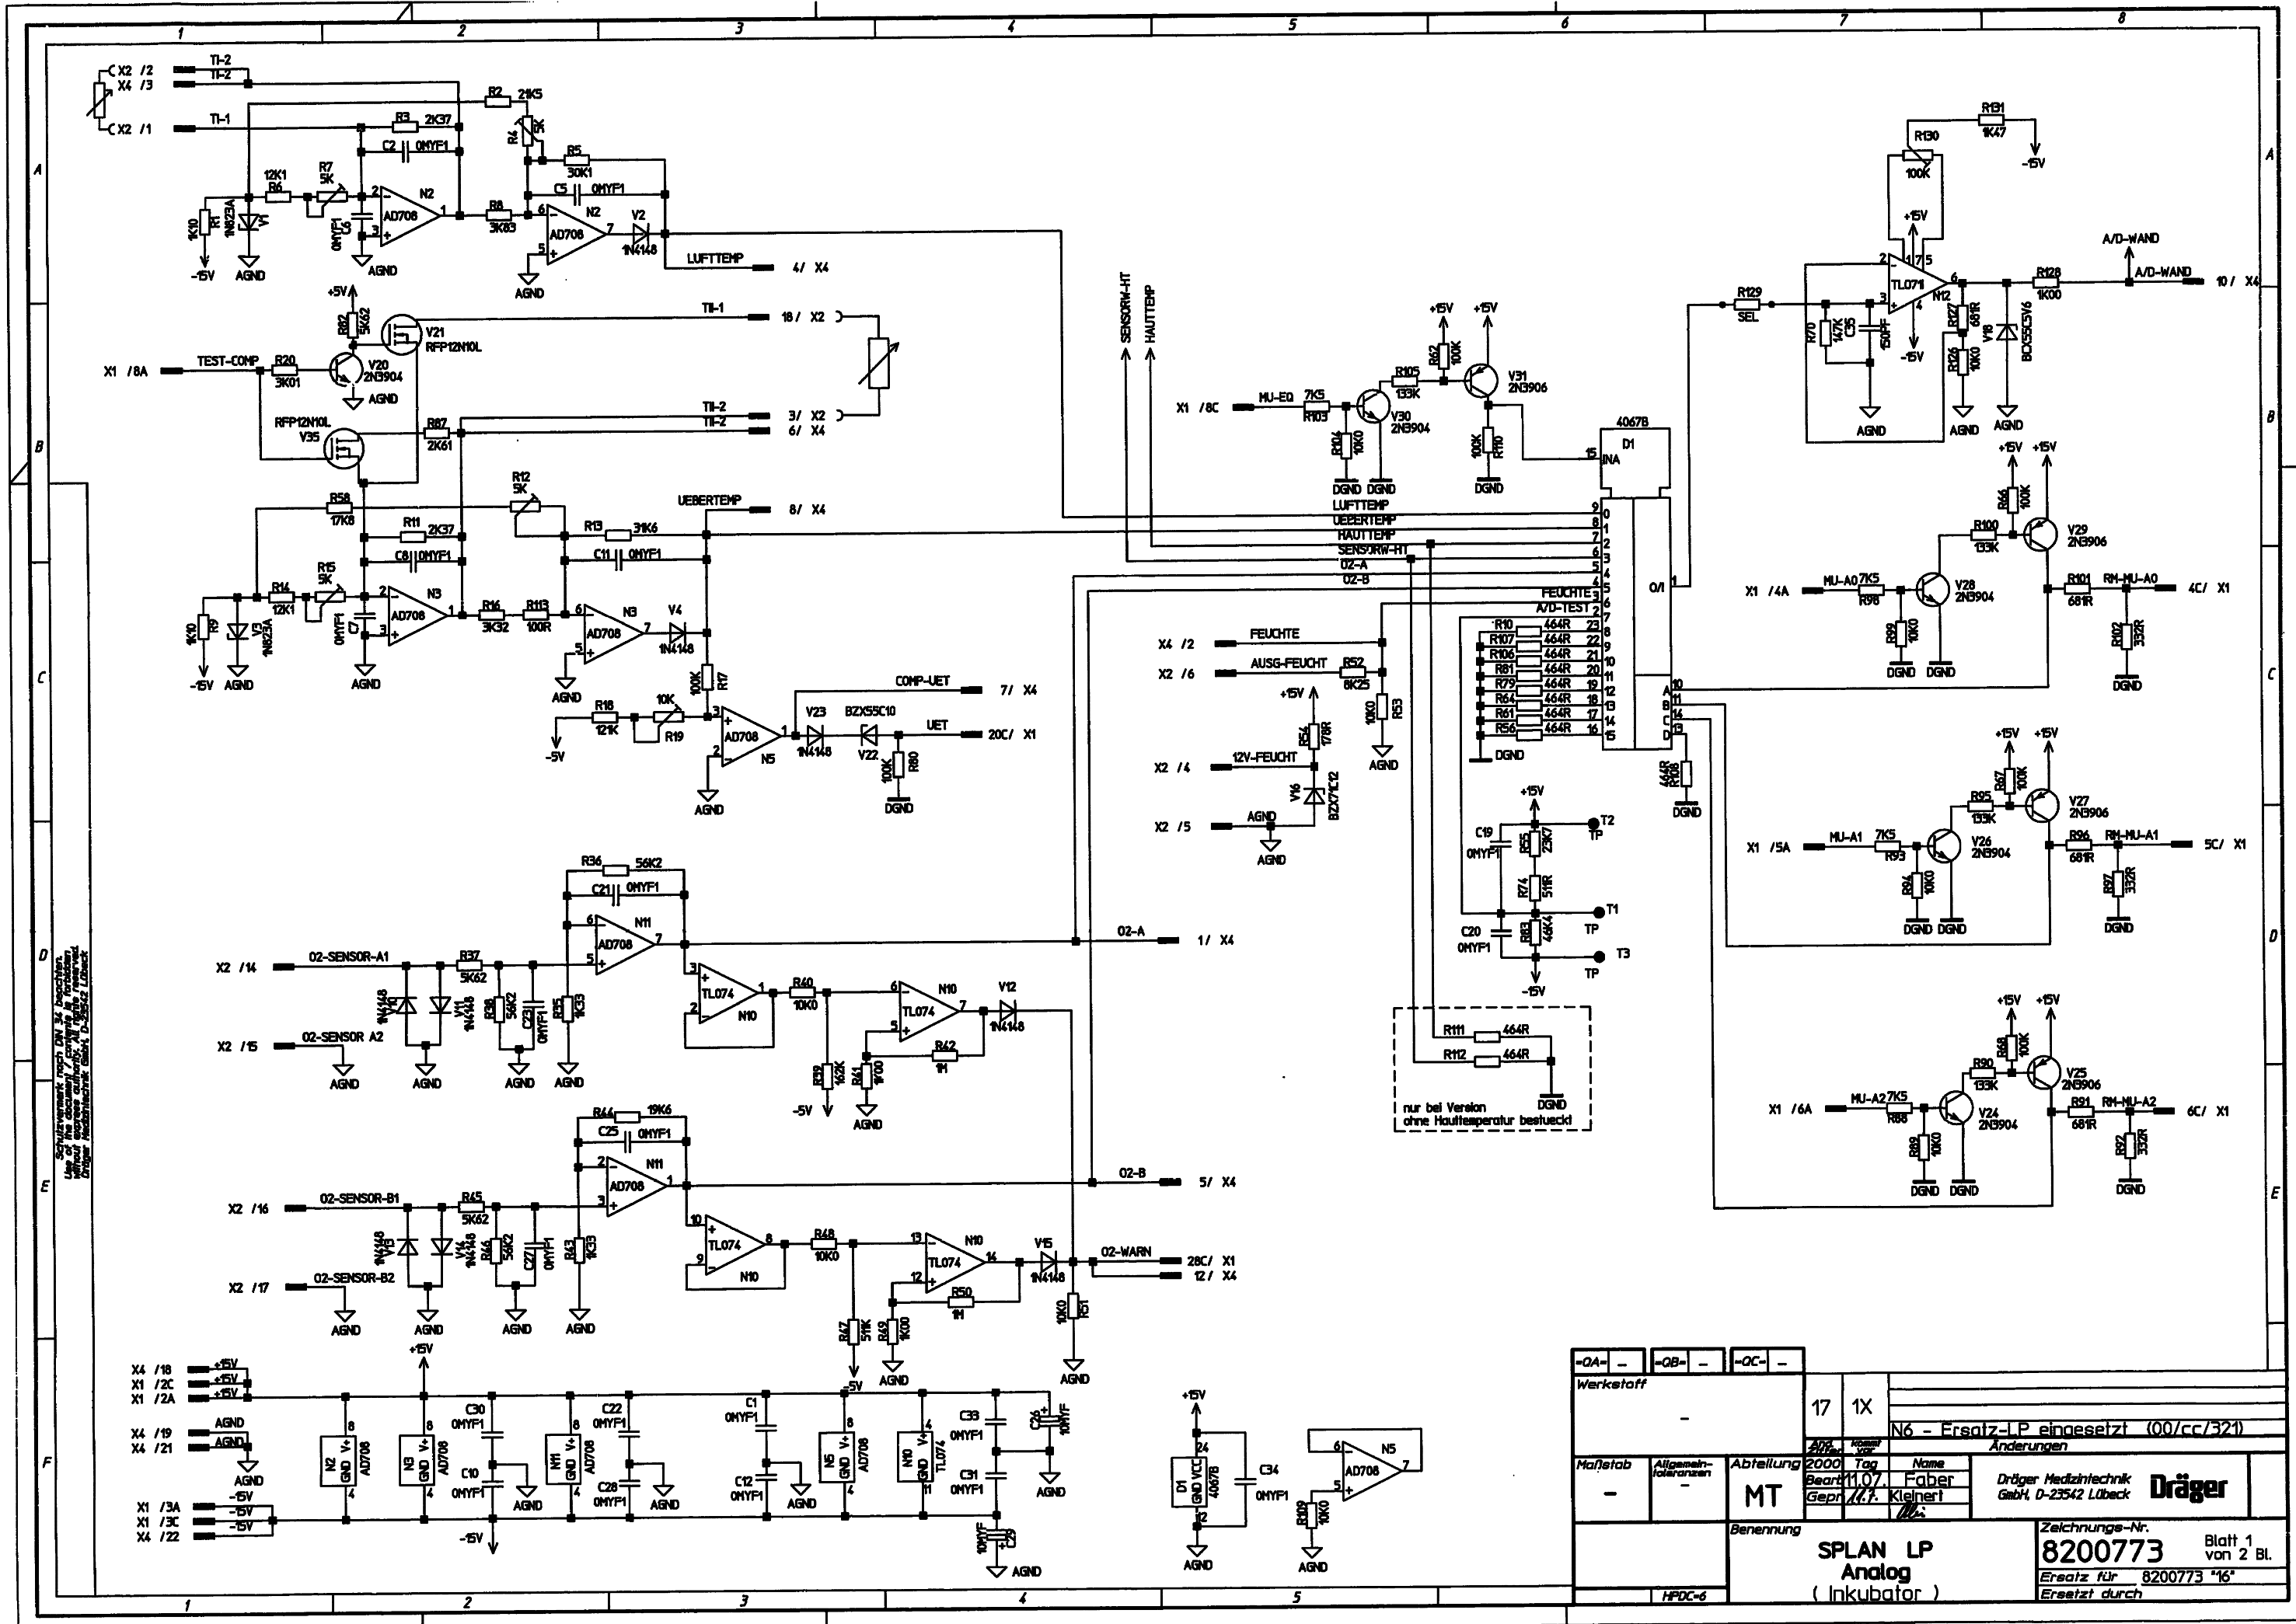

Schaltungsplan nach DIN 4637, Teil 1
 Use of this document is restricted to the
 original manufacturer's data.

-QA-	-QB-	-QC-		
Werkstoff		17 1X		
Maßstab		2000 Tag		
Allgemein- toleranzen		Name		
MT		Faber		
Benennung		Gepr. Kleinerl		
SPLAN LP Analog (Inkubator)		Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lütbeck		
HPDC-6		Zeichnungs-Nr. 8200773		Blatt 1 von 2 Bl.
		Ersatz für 8200773 "16"		
		Ersetzt durch		

